

Открытое акционерное общество «Научно - исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза»
ОАО «НИИК»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Юр. адрес: 606008, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 31,
адрес местонахождения ИЦ: г. Дзержинск, ул. Науки, 3А, тел. 24-60-88



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ ОАО «НИИК», к.т.н.

/А.Г. Скудин /

личная подпись расшифровка подписи

" 16 " 04 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 181/и от 16.04.20г.

Количество страниц в протоколе: 2

Вид испытаний: исследовательские

Наименование продукции: дезинфектор для рук и помещений ANTISEPTON

Предприятие-заказчик: ООО ТД «ХимАвто», Нижегородская обл., г. Дзержинск,
пр. Ленина д. 100, оф. 203

Предприятие-изготовитель: ООО ТД «ХимАвто», Нижегородская обл., г. Дзержинск,
пр. Ленина д. 100, оф. 203

Номера партий, проб и др. информация: ответственность за отбор проб несет
Заказчик, шифр образца 181/и

Дата поступления проб (образцов): 15.04.20г.

Дата проведения испытаний: 15.04.20г. - 16.04.20г.

Дата составления протокола: 16.04.20г.

Условия проведения испытаний: $t = 23^{\circ}\text{C}$, влажность 22%

Сведения о НД: ГОСТ 58151.3-2018 «Средства дезинфицирующие. Методы определе-
ния физико-химических показателей», ТУ 20.20.14-022-25603202-2020

Сведения о СИ, испытательном оборудовании:
прибор комбинированный Testo 608 H1 № 45006634, св-во № 19008966323 до 24.06.20г.;
набор ареометров АОН-1, клеймо до 12.21г.;
изм. комб. Seven в компл. с электр. № 1228315066, св-во № 19008966061 до 13.05.20г.;
хроматограф «Хромос ГХ-1000» № 923, св-во № 19008978455 до 05.02.21г.;
рефрактометр ИРФ-454 Б2М № 150164, св-во № 19008973818 до 22.09.20г.



Результаты испытаний


Наименование показателей	Методы испытаний	Допустимые уровни по ТУ	Результаты испытаний
1. Внешний вид	ГОСТ 58151.3-2018	Прозрачная однородная окрашенная жидкость с голубоватым оттенком, без механических примесей	соответствует
2. Плотность, г/см ³	ГОСТ 18995.1-73	0,810 - 0,910* * при температуре 20° С	0,896
3. Водородный показатель (рН), ед. рН	ГОСТ 22567.5-93	0 - 13	6,7
4. Показатель преломления, nD	ГОСТ 18995.2-73	1,355 - 1,365* * при температуре 20° С	1,3650
5. Концентрация активного вещества, %	М-02-505-82-01	не менее 65	67
6. Моющая способность, %	ГОСТ 58151.3-2018	Не менее 80	80



ДИРЕКТОР
ООО ТД «ХИМАВТО»
Орлова Е. А.

Ответственный за
составление протокола

Исполнители

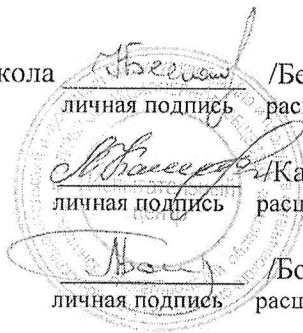

/Беспалова Н.Ф./
расшифровка подписи

/Каманова Л.Г./
расшифровка подписи

/Бондаренко А.В./
расшифровка подписи

Протокол действителен только для образцов, подвергнутых испытаниям.
Перепечатка и копирование без разрешения испытательного центра запрещена.